


1322



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1802.01.2025
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

LOTE 1							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPÃO E PEDAL BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPÃO E PEDAL	Unidade	4	HOSPIMETAL	R\$ 255,65	DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.022,60
2	BIOBOIO HOSPITALAR BIOBOIO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TIPO TRÍPODO DOBRÁVEL ALTURA CERCADA A PARTIR DE 1,80 M. ABERTO TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GATÓRIAS	Unidade	3	SANTA CLARA	R\$ 2.099,33	DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 6.297,99
3	CABO PARA BISTURI Nº3 LÂMINA 10 A 17 2 GANCHO DE JOSEPH Nº 1 DELICADO 17CM 1 EXTRATOR DE COMEDAG TIPO ALEMÃO 2	Unidade	3	DESCARPACK	R\$ 2.263,39	DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 6.790,17
4	COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS	Unidade	1	SANTA CLARA	R\$ 134,57	CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 134,57
5	RESPONDERO CARDIOVISCOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO RESPONDERO CARDIOVISCOR COM MONITOR	Unidade	4	GNATUS	R\$ 22.619,00	VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS	R\$ 90.476,00
6	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL FOCO CIRÚRGICO MÓVEL	Unidade	1	HOSPIMETAL	R\$ 1.761,17	UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 1.761,17
7	PRANCHA LONGA PRANCHA LONGA	Unidade	2	SANTA CLARA	R\$ 564,67	SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.129,34
8	REFLETOR PARABÓICO DE LUZ FRIA REFLETOR PARABÓICO DE LUZ FRIA	Unidade	1	HOSPIMETAL	R\$ 396,26	TRÊSCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R\$ 396,26
9	SUPOORTE DE HAMPER SUPOORTE DE HAMPER	Unidade	2	HOSPIMETAL	R\$ 825,39	OTOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.650,78
VALOR TOTAL							R\$ 109.858,88
							CENTO E NOVE MIL, OTOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.

Prazo de entrega: conforme o edital.

Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Local de entrega: Conforme o edital.

Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.

Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA : 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaramos que nossa proposta eletrônica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos cumprir fielmente e integralmente todas as disposições contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sob pena de não aceitação da proposta.

Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133, de 2021.

Declaramos que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1802.01.2025 instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

*Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

*Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

*Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1802.01.2025 realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇO: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

Assinatura

Assinatura

Assinatura



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1802.01.2025-PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE.

LOTE/ITEM						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPA E PEDAL BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPA E PEDAL	UNIDADE	4	JSN	R\$ 255,85	R\$ 1.022,60
2	BIOMBO HOSPITALAR BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TIPO TRIPLO DOBRÁVEL ALTURA CERCADE A PARTIR DE 1,80 M, ABERTO TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATORIAS	UNIDADE	3	TUBOMED	R\$ 2.099,33	R\$ 6.297,99
3	CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA 1 CABO PARA BISTURI N43 LÂMINA 10 A 172 GANCHO DE JOSEPH Nº 1 DELICADO 17CM 1 EXTRATOR DE COMEDÃO TIPO ALFÂN 2 PINÇA HALLSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA 1 TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR T/C VÍDEA 12 CM 1 PINÇA ADSON COM DENTE 1X2 12 CM 1 PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA 14 CM 1 TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM 1 ESTOJO DE INOX PERFURADO 18X08X05 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS	UNIDADE	3	ABC	R\$ 2.263,39	R\$ 6.790,17
4	COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS.	UNIDADE	1	VIDA RESGATE	R\$ 134,57	R\$ 134,57
5	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO - CARDIOVERSOR BIFÁSICO INSTRAMED CARDIOMAX-DIMENSÕES COM PAS: 30,0 CM LARGURA, 21,5 CM PROFUNDIDADE, 28,0 CM ALTURA. PESO: APARELHO - 5,15 KG. BATERIA NIMH - 1,10 KG. BATERIA LI-ION - 0,80 KG.PÁS EXTERNAS - 0,85 KG. EQUIPAMENTO COMPLETO BATERIA NIMH 7,10 KG EXCETO PANI. EQUIPAMENTO COMPLETO BATERIA LI-ION 6,80 KG EXCETO PANI. ELÉTRICO-AC: 100 A 265 VAC, 50/60 HZ SELEÇÃO AUTOMÁTICA. DC EXTERNO: 11 A 16 VDC. BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL: TIPO: NIMH, 14,4 VDC 4,5 A/H. DURAÇÃO:BATERIA COM CARGA PLENA - 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA COMPLETAMENTE DESCARREGADA: 8 HORAS. BATERIA OPCIONAL**: TIPO: LI-ION, 14,8 VDC 4,4 A/H.DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA COMPLETAMENTE DESCARREGADA: 8 HORAS. **CONSULTAR DISPONIBILIDADE. MEMÓRIA: TIPO: FLASH NAND, CAPACIDADE: 2 MBYTES, PACIENTES ARMAZENADOS: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ECG: GRAVAÇÃO D CTR - CHECAGEM EM TEMPO REAL DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION: AUTO-DIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO A REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉCONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES. SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE	UNIDADE	4	CMOSDRAKE	R\$ 22.619,00	R\$ 90.476,00
6	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL FOCO CIRÚRGICO MÓVEL	UNIDADE	1	MEDPEJ	R\$ 1.761,17	R\$ 1.761,17
7	PRANCHA LONGA PRANCHA LONGA	UNIDADE	2	VIDA RESGATE	R\$ 664,67	R\$ 1.329,34
8	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA.	UNIDADE	1	MEDPEJ	R\$ 396,26	R\$ 396,26
9	SUPOORTE DE HAMPER, SUPOORTE DE HAMPER	UNIDADE	2	TUBOMED	R\$ 825,39	R\$ 1.650,78
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$	109.858,88

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	109.858,88
cento e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO.
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NA PROPOSTA ESTÁ INCLUSO TODOS OS TRIBUTOS, FRETES, TARIFAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO. A PROPOSTA DE PREÇOS COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CERTAME.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS/BENS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

FORTALEZA/CE, 24 DE MARÇO DE 2025.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
 À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE PACOTI
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1802.01.2025-PE
 DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/03/2025 - 18:00h
 DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 24/03/2025 - 14:00h

At: Sr(a) Preposto(a)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido pregão, bem como as informações especificações e as condições abaixo discriminadas

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO



LOTE 1								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUAND	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPÃO E PEDAL. BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPÃO E PEDAL.	Unidade	4	ECOBIM	R\$ 259,75	duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.039,00	mil e trinta e nove reais
2	BIOMBO HOSPITALAR. BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TIPO TRIPLO, DOBRÁVEL, ALTURA, CERCADE A PARTIR DE 1,80 M, ABERTO TIPO DE RODÍZIO, PONTEIRAS GIRATORIAS	Unidade	3	SANTA CLARA	R\$ 1.328,65	mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos	R\$ 3.985,95	três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos
3	CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA. CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA 1 CABO PARA BISTURI Nº3 LÂMINA 10 A 17 2 GANCHO DE JOSEPH Nº 1 DELICADO 17CM 1 EXTRATOR DE COMEDÃO TIPO ALEMÃO 2 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM 1 CURVA 1 TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR T/C VIDEA 12 CM 1 PINÇA ADSON COM "JEN" 1X2 12 CM 1 PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VIDEA 14 CM 1 TESOURA MAYO STILE HETA 15CM 1 ESTOJO DE INOX PERFURADO 18X08X05 CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRURGICOS	Unidade	3	ABC	R\$ 1.647,52	mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 4.942,56	quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
4	COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS. COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS.	Unidade	1	SS RESGATE	R\$ 185,54	cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 185,54	cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos
5	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO. DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO - CARDIOVERSOR BIFÁSICO INSTRUMED CARDIOMAX-DIMENSÕES COM PÁS 30,0 CM 1 LARGURA: 21,5 CM PROFUNDIDADE: 28,0 CM ALTURA: PESO: APARELHO - 5,15 KG. BATERIA NIMH - 1,10 KG. BATERIA LHON - 0,80 KG. PÁS EXTERNAS - 0,85 KG. EQUIPAMENTO COMPLETO BATERIA NIMH 7,10 KG. EXCETO PAINEL EQUIPAMENTO COMPLETO BATERIA LHON 6,60 KG EXCETO PAINEL ELÉTRICO AC: 100 A 265 VAC, 50/60 HZ SELEÇÃO AUTOMÁTICA. DC EXTERNO: 11 A 16 VDC. BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL TIPO: NIMH, 14,4 VDC 4,5 A/H. DURAÇÃO BATERIA COM CARGA PLENA - 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA COMPLETAMENTE DESCARREGADA: 8 HORAS. BATERIA OPCIONAL** TIPO: LHON, 14,8 VDC 4,4 A/H. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA COMPLETAMENTE DESCARREGADA: 8 HORAS. **CONSULTAR DISPONIBILIDADE. MEMÓRIA: TIPO: FLASH NAND. CAPACIDADE: 2 MBYTES. PACIENTES ARMAZENADOS: > 150 PACIENTES.	Unidade	4	CMOS DRAKE	R\$ 44.527,35	quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos	R\$ 178.109,44	cento e setenta e oito mil, cento e nove reais e quarenta e quatro centavos
6	FOCO CIRURGICO MÓVEL. FOCO CIRURGICO MÓVEL.	Unidade	1	MEDPEJ	R\$ 3.710,62	três mil, setecentos e dez reais e sessenta e dois centavos	R\$ 3.710,62	três mil, setecentos e dez reais e sessenta e dois centavos
7	PRANCHA LONGA. PRANCHA LONGA.	Unidade	2	SS RESGATE	R\$ 666,06	seiscentos e sessenta e seis reais e seis centavos	R\$ 1.332,12	mil trezentos e trinta e dois reais e doze centavos
8	REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA. REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA.	Unidade	1	MIKATOS	R\$ 1.113,19	mil cento e treze reais e dezanove centavos	R\$ 1.113,19	mil cento e treze reais e dezanove centavos
9	SUPORTE DE HAMPER. SUPORTE DE HAMPER.	Unidade	2	TUBOMED	R\$ 545,10	quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos	R\$ 1.090,20	mil e noventa reais e vinte centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 195.508,65	
cento e noventa e cinco mil, quinhentos e oito reais e sessenta e cinco centavos								

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 195.508,65
cento e noventa e cinco mil, quinhentos e oito reais e sessenta e cinco centavos	

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nosso Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão incluídos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.


Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) Validade da proposta: 60 (SESENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;
 b) Prazo de entrega: conforme edital.

21 de março de 2025.

Handwritten signatures and initials.

Lixeira Com Pedal 25 litros Cinza Gruplast

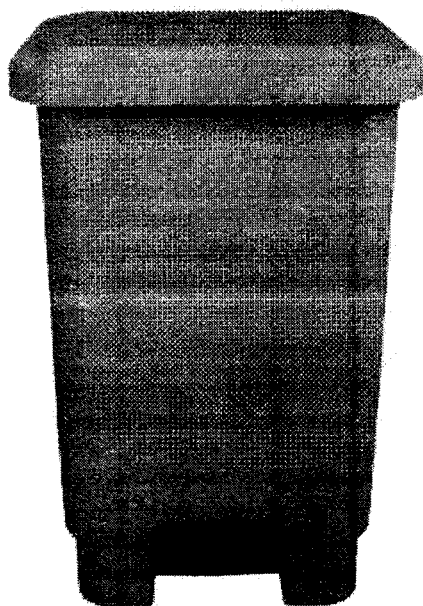

Formato Empilhável;

Pedal Embutido;

Suporte para Sacos Plásticos;

Dimensões Externas: 37 cm (largura) x 34,5 cm (comprimento) x 57 cm (altura);

Peso do Produto: 2,558 kg;

Capacidade Volumétrica: 25 litros;

Cubagem por Volume: 0,0727 m³.

Handwritten signature

Handwritten mark


BIOMBOS

Com estrutura e arborização em madeira, revestida por PVC antiodorante, sem costura, tecido sintético tipo tela de 250g/m² (qualidade em uma lateral, tecido diferente na lateral).

MODELOS

- **LV 06** - 1 unidade, 100cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade.
- **LV 144** - 1 unidade, 144cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade.
- **LV 360** - 1 unidade, 360cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade.
- **LV 1440** - 1 unidade, 1440cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade.

Dimensões padrão:
Esp. L: 1,20m x A: 1,00m.
Tipos: C: 1,20m x A: 1,00m.

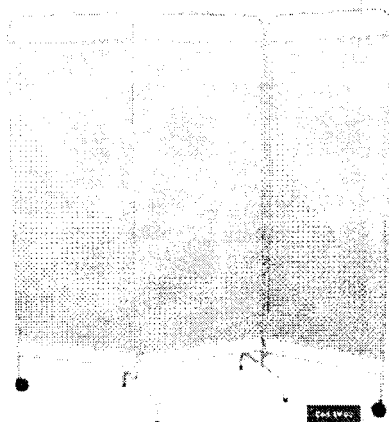


COL LV 06

BIOMBO PLUVIFERO

LV 02 - Biombo de proteção pluvial, com 2m de altura, 100cm de largura, 100cm de profundidade. Extensão em chapa de aço inoxidável com acabamento em pintura epóxi, 20cm de esp. Manuseio sobre rodízios, quadras de 25cm de esp. com rodas.

Dimensões padrão: C: 0,60m x A: 1,00m x L: 0,60m.

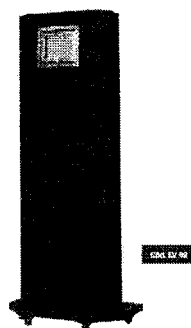


COL LV 02

NEGATOSCÓPIO COM LÂMPADA FLUORESCENTE


Para uso em parede ou mesa, controlado em chapa de aço, vidro em poliestireno leitoso, permitindo luz uniforme. Lâmpada fluorescente circular de 80 watts, 127 volts. Chave liga/desliga, prendedor de RX, prendedor em aço inox (OPCIONAL - 220 volts).

MODELOS

- **LV 70** - 1 unidade, 70cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 71** - 1 unidade, 71cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 92** - 1 unidade, 92cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 113** - 1 unidade, 113cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 70i** - 1 unidade, 70cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 71i** - 1 unidade, 71cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 92i** - 1 unidade, 92cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 113i** - 1 unidade, 113cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.



COL LV 70



COL LV 113i

NEGATOSCÓPIO COM LÂMPADA LED

Para uso em parede ou mesa, controlado em chapa de aço, vidro em poliestireno leitoso, permitindo luz uniforme. Lâmpada LED de 9 watts. Alimentação 127 volts, alimentação 220 volts, prendedor de RX por rolete em aço inox.

MODELOS

- **LV 70 LED** - 1 unidade, 70cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 71 LED** - 1 unidade, 71cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 92 LED** - 1 unidade, 92cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 113 LED** - 1 unidade, 113cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 70i LED** - 1 unidade, 70cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 71i LED** - 1 unidade, 71cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 92i LED** - 1 unidade, 92cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.
- **LV 113i LED** - 1 unidade, 113cm de largura, 100cm de altura, 100cm de profundidade. Dimensões: C: 0,60m x P: 0,10m x A: 0,60m.

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



Rhosse

CNPJ 04.440.002/0001-52

AUT. FEDERAL/MS U904YW4L815M

Os instrumentos Rhosse que você acaba de adquirir são confeccionados com materiais primas selecionadas que resultam no aço inox mais nobres do mercado voltado para as finalidades da área da saúde. Algumas advertências abaixo vão garantir que você tenha 100% de aproveitamento dos instrumentos em suas funções primárias:

- Não submeta seus instrumentos a produtos que ofereçam risco de corrosão. Instrumentos com marcas de corrosão perdem sua garantia para os defeitos considerados de fabricação.
- Não identifique os nossos instrumentos cirúrgicos com gravações abrasivas, que reproduzam, fissuras em baixo relevo, popularmente conhecidas como "Gravação de Relojoeiro". Isso irá comprometer a resistência do seu instrumental e resultará em perda da garantia mesmo em casos de defeitos de fabricação.
- Em caso de identificação por fita colorida, é importante ressaltar que de acordo com a qualidade dessas fitas, ao se depararem com o aquecimento gerado no processo de esterilização em autoclaves, essas fitas poderão reagir à temperatura, provocando desgaste químico na superfície do instrumental, o que também resulta em perda total da garantia por defeitos de fabricação.

OXIDAÇÃO: grande parte dos casos de problemas ligados a oxidação está diretamente ligado aos procedimentos de enxague e secagem. Apesar de o nome sugerir que o aço do instrumental cirúrgico é AÇO INOX que seria em tese abreviatura de inoxidável, é importante dizer que existem inúmeras formulas com quantidades diferentes de compostos que podem resultar na mistura popularmente conhecida como aço inox. O principal item dessa mistura que ao alterar sua concentração para mais, aumenta o risco de gerar pontos de oxidação. Seguindo as exigências da legislação da ANVISA, alguns tipos de aço inox são habilitados a produção de instrumentos cirúrgicos no Brasil. Os mais usados buscando os preceitos de durabilidade, aliada a maleabilidade, poder de corte, travamento, segurança, são AISI304 e AISI420, ambos com diferentes percentuais de carbono. Quanto mais carbono maior o risco de oxidação em caso de exposição prolongada a umidade.

POR ISSO É EXTREMAMENTE IMPORTANTE DIZER QUE:

- Em caso de mau uso seu instrumental poderá oxidar
- Evite deixar exposto por muito tempo a secreções, notadamente sangue, que devido a sua composição poderá

provocar pontos de corrosão. Priorize deixar os instrumentos utilizados banhados em solução salina até que sejam devidamente higienizados;

- Evite o uso de "degermantes" à base de aldeídos;
- Evite exposição o saponáceo com enxague inadequado ao ir para a autoclave o mesmo apresentará pontos e manchas;
- PRIORIZE a secagem de forma ativa. Primeiramente com um pano de algodão, intensificando com secadoras de ar comprimido ou similares;
- Se seu instrumental ficar secando inerte aos pontos de água ele poderá resultar em pontos ou manchas escuras normalmente confundidas com defeitos, porém basta secar esse excesso e esse problema não se repetirá;
- Autoclaves com aquecimento acima dos padrões exigidos pela ANVISA poderão superaquecer seus instrumentos, provocando mudanças em sua coloração, e em casos mais graves interferir na qualidade desses instrumentos, por isso revise anualmente seus equipamentos de Biossegurança e evite prejuízos;

REQUISITOS GERAIS DE MANUTENÇÃO: A prevenção é o segredo. Um bom profissional responsável pela manipulação e processamento dos seus instrumentos, poderá oferecer longevidade ao seu instrumental. Por isso certifique-se de que ele está habilitado para oferecer manutenção diária a seus instrumentos visando garantir por mais tempo a qualidade esperada:

- Indicamos que todo Instrumento articulado deve passar por lubrificação logo após a limpeza, e antes da esterilização, conforme citado no check list de reprocessamento de instrumentos cirúrgicos.
- Observe se os produtos químicos utilizados na limpeza são para aplicação médica e em aços inox.
- A água utilizada para limpeza e esterilização deve estar de acordo com as normas nacionais e internacionais para qualidade da água.

COMPROMISSO RHOSSE: Caso um dia você precise oferecemos um sistema de garantia e manutenção sem precedentes no ramo: A Rhosse possui procedimentos exclusivos na fabricação de seus instrumentos cirúrgicos. Nosso compromisso é oferecer o que há de melhor em matéria prima e instrumentos de altíssima qualidade. Para que possamos fazer jus a nossa intenção oferecemos garantia de 10 anos para defeitos de fabricação, e garantia permanente para manutenção ou conserto de instrumentais, obedecendo é claro os princípios de utilização adequada ou defeitos provenientes por falhas no processo fabril, ou de resistência do material a quebras

SAC: 0800 7070 667
rhosse.com.br

Rhosse

MANUAL DE ESTERILIZAÇÃO E CUIDADOS COM SEUS INSTRUMENTAIS

Os Instrumentos Cirúrgicos Rhosse são produtos invasivos de uso transitório reutilizável, e que abrangem em espécies de Classe I e Classe II. A matéria prima principal dos instrumentos cirúrgicos Rhosse é aço inox, e está de acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 7153 1. A indicação dos instrumentos cirúrgicos Rhosse em geral, visa auxiliar, profissionais da saúde em intervenções cirúrgicas ou procedimentos ambulatoriais, voltado para o uso em público adulto e pediátrico. Nossos produtos seguem rígidos padrões de acordo com a legislação vigente da ANVISA

Nossa garantia prevê troca imediata dos instrumentos configurados defeituosos, e manutenção gratuita em caso de desgaste do material por tempo de uso, como perda de corte, polimento, ajustes etc. Apenas nos eximimos de gratuidade caso o defeito seja resultado de mau uso do instrumental e em trâmites logístico de envio e recebimento desse material desde a sua clínica até nossa empresa e volta. Buscando evitar que alguns maus costumes possam dar origem a defeitos por stress do material, solicitamos evitar ações indesejadas, porém comuns, que geram perda de garantia: Nunca afie uma tesoura Rhosse, ou envie o instrumental Rhosse qualquer que seja para ser revisado ou consertado em locais desconhecidos e quem não tenham o conhecimento de nosso departamento de Assistência Técnica;

IMPORTANTE

Nossos instrumentos não estão esterilizados. Por isso, antes de seu primeiro uso, o mesmo deverá passar pelo processo de limpeza e esterilização padrão adotado em sua CME.

EXIGÊNCIAS:

Todo instrumental cirúrgico de aço inox, tende a ser reutilizável. Segundo exigências da ANVISA e descrito em detalhes na RDC15, é obrigatório realizar o reprocessamento antes do seu uso ou reuso. Portanto ao retirar o seu instrumental da embalagem, dirija-o imediatamente a CME providencias imediatas de limpeza e esterilização. Os instrumentos Rhosse não possuem restrições relativas à quantidade máxima de reprocessamentos.

A Rhosse exime-se da responsabilidade, por problemas causados, pelo descumprimento dos procedimentos de limpeza e esterilização, padronizados por lei. Garantir a segurança na utilização dos produtos reprocessados, e a manutenção periódica dos materiais utilizados, é função da responsável técnica do seu estabelecimento.

SAC: 0800 7070 667
rhosse.com.br



Rhosse

LIMPEZA PREVIA: é o processo de remoção de sujidades ou desincrustação. Para um melhor resultado os instrumentos deverão ser mergulhados, à temperatura ambiente, em recipiente apropriado contendo soluções enzimáticas, em concentração e exposição de tempo, conforme determinação do fabricante destas soluções químicas. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente. Após a imersão, em ambos os casos, deve-se realizar a limpeza manual com inspeção escovação das superfícies, ranhuras e lumens acessíveis. O profissional habilitado deve realizar o procedimento utilizando escovas com cerdas macias. Nunca utilize palhas ou esponjas de aço e produtos abrasivos com risco de perda de garantia do seu instrumental;

DESCONTAMINAÇÃO: é o processo físico ou químico que elimina a maioria dos microrganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos. O instrumento deve ser imerso em recipiente apropriado contendo solução desinfetante (que não compromete a integridade do instrumento) à temperatura ambiente ou em banhos aquecidos. A concentração e a exposição de tempo do instrumento na solução desinfetante devem seguir as determinações do fabricante destas soluções.

LAVAGEM: é o processo de remoção mecânica de sujidades, visíveis ou invisíveis a olho nu. A lavagem poderá ser manual ou automática. Quando manual, o instrumento deve ser totalmente escovado, com escova de cerdas macias, utilizando detergente enzimático. Nunca utilize palhas ou esponjas de aço e produtos abrasivos. Se a sua tendência for adequar-se a RDC 15 será obrigatório submeter os instrumentos cirúrgicos COMPLEXOS em solução enzimática em Lavadoras Ultrassônicas. Apesar de indicarmos o uso de Lavadora Ultrassônica, para os instrumentos Não Complexos, seu uso é facultativo. Quando automática, o instrumento deve ser lavado conforme especificações do fabricante da máquina.

ENXAGUE: é nesse momento que sua atenção deverá ser redobrada. Nessa fase deverá se priorizar a remoção de resíduos químicos, detergentes, enzimáticos e espumas residuais. O instrumento deve ser enxaguado em água corrente abundante, mas para longevidade de seus instrumentos cirúrgicos e seguindo a legislação, a água utilizada no enxague não poderá ser qualquer tipo de água. A água utilizada deve ser destilada, deionizada ou desmineralizada.

SECAGEM: é o processo de remoção de água residual e principalmente da umidade que poderá se alojar em porções de difícil acesso dos instrumentos cirúrgicos. Quer sejam eles Complexos

ou Não Complexos, nessa fase, o segredo é não deixar vestígios de água, ou umidade. Por isso submeta todo seu instrumental a uma secagem minuciosa e detalhada. Mesmo que seja pouca, a umidade poderá causar danos permanentes a seus instrumentos. Utilize-se de toalhas ou panos de algodão, e caso não tenha acesso a secadora de ar comprimido, busque alternativas similares no mercado a fim de garantir acesso às junções serrilhas lumens de difícil acesso manual. NUNCA deixe seu instrumental secar sozinho nas grades de secagem, sob o risco de no futuro apresentar pontos irreversíveis de corrosão ou oxidação.

INSPEÇÃO: A inspeção é o processo de fiscalização, por profissional habilitado, das condições de integridade do instrumento e da eficácia do processo de limpeza. Caso algo se mostre suspeito deve-se repetir o ciclo e realizar a limpeza novamente. O instrumento que apresentar indícios de corrosão deverá ser segregado.

LUBRIFICAÇÃO: Invariavelmente será necessário que alguns instrumentos passem por um processo de lubrificação. Porém não poderá ser utilizado nenhum tipo de lubrificante artificial, que ofereça riscos aos instrumentais, e a saúde dos pacientes. Limite-se a um processo de aplicação, de lubrificante hidrossolúvel e não corrosivo adequado à aplicação médica. Deve-se dar especial atenção às juntas de instrumento articulado.

ESTERILIZAÇÃO: O processo recomendado a esterilização dos instrumentos Rhosse sempre será, a Esterilização por vapor saturado, ou Autoclaves de Vapor, que visam à eliminação total dos microrganismos (vírus, bactérias, micróbios e fungos), seja na forma vegetativa ou esporulada. O instrumento, totalmente limpo e SECO, deve ser embalado de acordo com as exigências da ANVISA, contidas na RDC15. A embalagem mais comum e atualmente mais utilizada é a de papel grau cirúrgica permeável. O processo de esterilização por vapor saturado deve seguir rigorosamente as especificações do fabricante da autoclave.

Como sugestão, sempre que possível no processo de esterilização tente reunir os seus instrumentos cirúrgicos por fabricante. Assim poderá se observar as diferentes características de manutenção de cada instrumental, ficando mais fácil detectar influência de instrumentos por algum tipo de incompatibilidade de compostos, mecânica e dimensional que poderão danificar os instrumentos de diferente natureza.

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM: Quando não estiver em uso, conserve seu instrumental Rhosse em temperatura ambiente em locais secos, bem protegidos da umidade. Respeite o prazo de validade das suas esterilizações. Evite armazenar seu instrumental junto com produtos químicos não assépticos ou produtos químicos que possam desprender gases corrosivos.


CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE: Durante o uso todo instrumento deve ser transportado por pessoas habilitadas. Instrumentos não necessitam de cuidados especiais, pois sua composição em aço inoxidável resiste a movimentos leves de pouca agressividade. Evite jogar, torcer, ou fazer uso indevido de seus instrumentos evitando atritos mais fortes para que sua forma original não se altere e evite quebras.


CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO: O instrumento cirúrgico Rhosse, só deve ser manipulado e ou utilizado por profissionais da saúde com habilidade para o procedimento.

DESCARTE: Todo estabelecimento de serviço de saúde é responsável pelo gerenciamento de resíduos e rejeitos de serviços de saúde devendo atender à legislação ambiental e sanitária vigentes. Caso o instrumental esteja inutilizado, devido a danos causados por Imperícia do operador, ao desgaste natural do instrumento ou a qualquer alteração no seu funcionamento, deve ser descartado. Caso tenha dificuldade no descarte desse tipo de materiais, a Rhosse oferece esse serviço para você, desde que enviados sem custos para o endereço da Rhosse aos cuidados de nossa assistência técnica.

REGISTROS MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS CORTANTES	80310620010
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS CORTANTES	80310620011
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES	80310620006
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS NÃO CORTANTES	80310620005
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES COM VÍDEA	80310620008
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS CORTANTES COM VÍDEA	80310620007
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES COM VÍDEA	80310620009



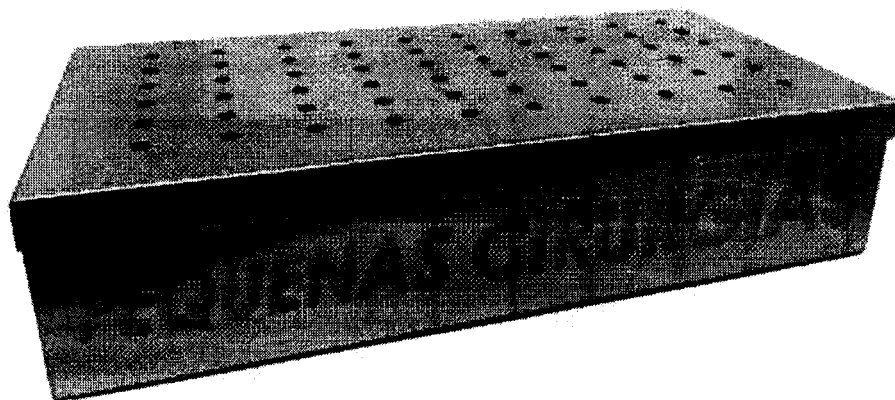

Caixa para Pequenas Cirurgias

Autoclavável: Sim

Garantia: 1 a 10 anos de acordo com o item específico

NCM: 90189099

Certificados: RDC 665/2022 ANVISA

Registro MS ANVISA: 80310620012 | 80310620014 | 80310620016

Dr.
8

	01	<u>Cabo de Bisturi Nº 3</u>
	02	<u>Gancho O'Hles Simples Delicado</u>
	01	<u>Pinça Pean 14cm</u>
	01	<u>Pinça Mosquito Curva 12cm</u>
	01	<u>Tesoura Iris Faceta Curva Ponta Fina 11cm</u>
	01	<u>Porta Agulha Mayo Hegar com Videa 12cm</u>
	01	<u>Pinça Adson Dente de Rato 12cm</u>
	01	<u>Pinça Adson Serrilhada 12cm</u>
	01	<u>Porta Agulha Mayo Hegar com Videa 14cm</u>
	01	<u>Tesoura Mayo Reta 15cm</u>

De

CM


2



	01	<u>Pinça Adson Dente de Rato 12cm</u>
	01	<u>Pinça Adson Serrilhada 12cm</u>
	01	<u>Porta Agulha Mayo Hegar com Videa 14cm</u>
	01	<u>Tesoura Mayo Reta 15cm</u>
	01	<u>Estojo de Inox Perfurado 20 x 10 x 03cm</u>

de

6

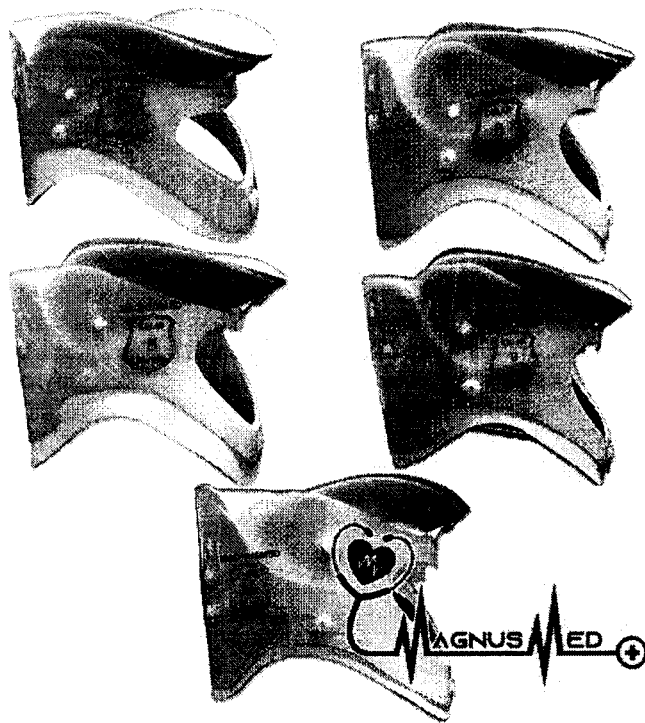

Kit Colar Cervical Resgate para Resgate Tipo Stiffneck

1 Extra Pequeno

1 Pequeno

1 Médio

1 Grande

1 Extra Grande

Validade indeterminada

O colar cervical da Resgate SP é feito em polietileno de alta densidade, revestido com EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. O colar é um equipamento indicado para imobilização de pessoas acidentadas que precisam ser socorridas e transportadas com segurança.

Características do produto

- Fecho de velcro;
- Feito em polietileno de alta densidade;

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- Revestido em EVA;
- Suporte mentoniano, ou seja, para o queixo;
- Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia;
- Abertura posterior para palpação e ventilação da nuca;
- Uso único;
- Descartável.

Especificações Técnicas

- Contém: 01 colar cervical;
- Tamanho: P - M - G -;
- Cor do velcro: Azul, Laranja, Verde;
- Composição: polietileno, EVA, velcro e botões de nylon;
- Não estéril;



De JA

2



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	14.365.637/0001-96	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.09.146-9
Nome do Dispositivo Médico	SÉRIE TEC 5600 (TEC-5601/TEC-5611/TEC-5621/TEC-5631)		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO / SEMI-AUTOMÁTICO EXTERNO		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80914690011		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.635664/2014-08</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION - TOMIOKA PRODUCTION CENTER - JAPÃO - CNPJ / Código Único: C005474 - Endereço: 1-1 TAJINO, TOMIOKA-SHI, GUNNA 370-2314		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - ALTO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	18/02/2015		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	18/02/2035		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	TEC5600-por-BRA-OM-0616-904100C_1A_secured f_Parte7.pdf	4490803/21-4 - 12/11/2021 - 02:23
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	TEC5600-por-BRA-OM-0616-904100C_1A_secured f_Parte8.pdf	4490803/21-4 - 12/11/2021 - 02:23
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	TEC5600-por-BRA-OM-0616-904100C_1A_secured f_Parte6.pdf	4490803/21-4 - 12/11/2021 - 02:23

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL
DO USUÁRIO DO PRODUTOTEC5600-por-BRA-OM-0616-
904100C_1A_secured f_Parte5.pdf4490803/21-4 -
12/11/2021 - 02:23INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL
DO USUÁRIO DO PRODUTOTEC5600-por-BRA-OM-0616-
904100C_1A_secured f_Parte4.pdf4490803/21-4 -
12/11/2021 - 02:23INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL
DO USUÁRIO DO PRODUTOTEC5600-por-BRA-OM-0616-
904100C_1A_secured f_Parte2.pdf4490803/21-4 -
12/11/2021 - 02:23INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL
DO USUÁRIO DO PRODUTOTEC5600-por-BRA-OM-0616-
904100C_1A_secured f_Parte3.pdf4490803/21-4 -
12/11/2021 - 02:23INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL
DO USUÁRIO DO PRODUTOTEC5600-por-BRA-OM-0616-
904100C_1A_secured f_Parte1.pdf4490803/21-4 -
12/11/2021 - 02:23**Modelo Produto Médico**

TEC-5601

TEC-5611

TEC-5621

TEC-5631


Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

cardiolife

Desfibriladores TEC-5600

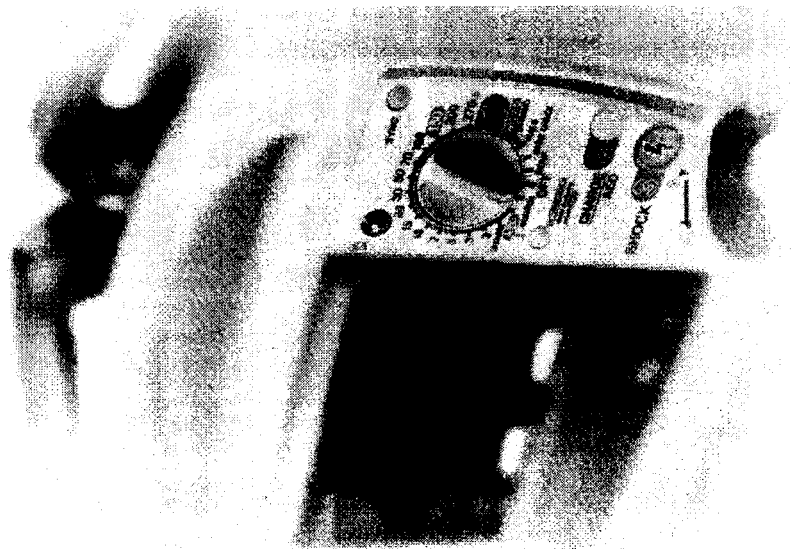

Qualidade na
Reanimação


Fighting Disease with Electronics
NIHON KOHDEN

Eficiência no Choque

Rapidez nos choques e observação contínua

Mais de 4 segundos para começar o choque. A análise no carregamento contribui para a eficiência durante a entrega da energia quando o paciente é não identificável.


Modo DEA: Análise Contínua FV e Carga Standby

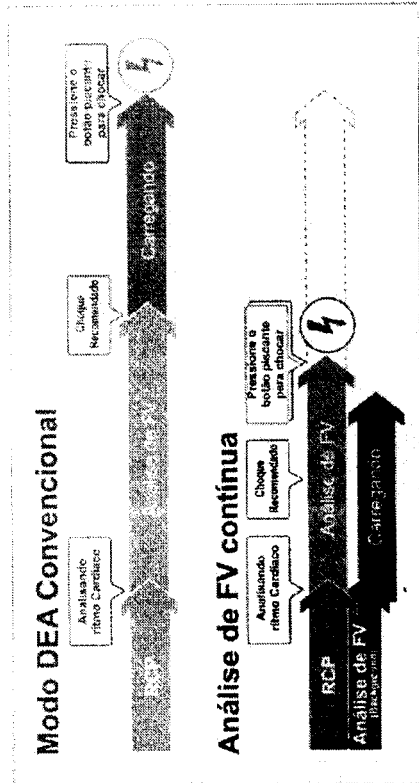

Eficiência na Reanimação

RCP de alta qualidade

com CINE e o melhor sensor Manstream do mundo. Este sensor de CO₂ tem uma resposta rápida na qual é útil para reconhecer a posição da tuba traqueal, garantir a qualidade do RCP e ser um indicador precoce para ROSC (Return of spontaneous circulation) durante o RCP, como recomendado pelas diretrizes internacionais.

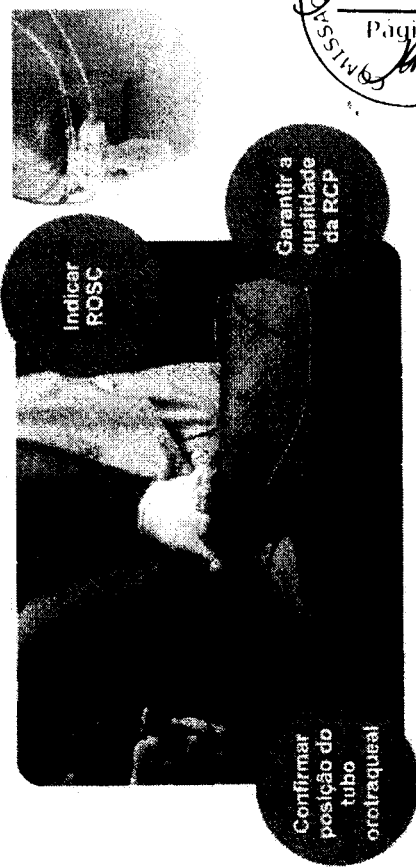

COMISSÃO DE LICITAÇÃO P.M. DE PACOTI-CE
1336
Página



Minimizar pausas durante a RCP

As pás adesivas Nihon Kohden são menos afetadas por desvio do eixo da base durante a RCP em comparação com as convencionais. É possível visualizar as curvas de ECG mesmo durante a compressão torácica.

Pás convencionais



Novas pás com supressão de artefatos

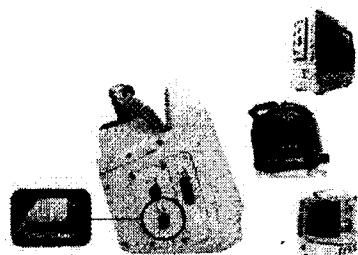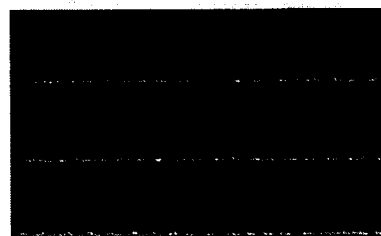


Transporte Inteligente

Os "Smart Cable" ECG, CO₂ e SpO₂ utilizados na linha de Monitores beira de Leito podem ser utilizados também na linha de desfibriladores Cardiolife Série TEC 5600.

Sempre visível

O ambiente de emergência nem sempre é favorável aos desfibriladores. Fora da ambulância, a luz do dia pode interferir com a visibilidade da tela LCD. Com uma backlit LCD de alta potência, a série TEC 5600 fornece visibilidade clara, mesmo sob luz solar intensa.

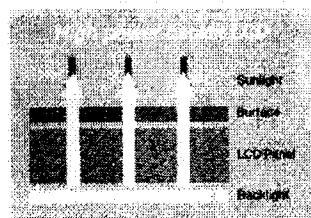

Ambientes versáteis

• Temperatura



• Grau de Proteção



• Vibração

MIL-STD-810F 514.5 Categoria 4 (Veículo com carga)
MIL-STD-810F 514.5 Categoria 9 (Helicóptero)


Linha de Cardioversores

	Pás externas	Pás descartáveis	Pás internas	ECG de 3/6 xms	Cardioversão	Modo DEA	Impressora	SpO ₂ (opcional)	CO ₂ (opcional)	Monitoragem Transcutânea
TEC-5601	✓							✓	✓	
TEC-5611		✓		✓	✓	✓	✓		✓	
TEC-5621	✓	(paciente)	(paciente)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TEC-5631	✓	(paciente)	(paciente)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas

Dimensões	311 (W) x 288 (H) x 242 (D) mm
Peso	TEC-5601: 6.4 kg (Incluindo bateria e pás externas) TEC-5611: 5.7 kg (Incluindo bateria) TEC-5621: 6.8 kg (Incluindo bateria e pás externas) TEC-5631: 6.9 kg (Incluindo bateria e pás externas)
Tela	LCD colorida de 6,5 polegadas
Seleção de energia	2 a 270J
Tempo de operação da bateria	180 min de monitorização 100 descargas de 270J 120 min de marcapasso
Tempo de carga	Menos de 4seg para 200J (tanto na bateria quanto na corrente elétrica)

Opções

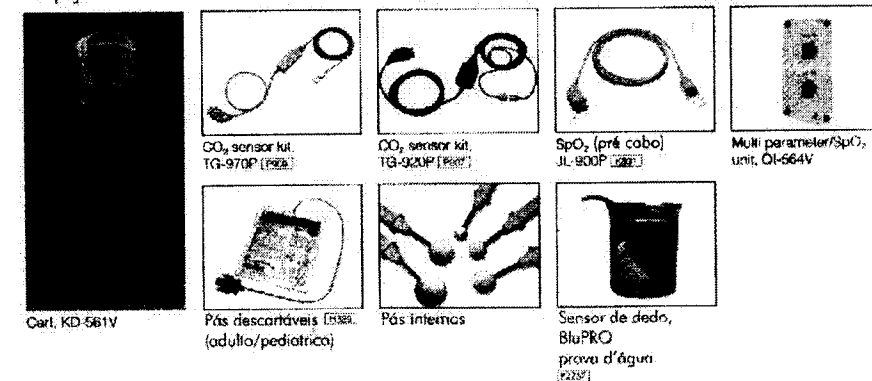

NIHON KOHDEN

NIHON KOHDEN BRASIL LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1507 - Bloco A - q 91A
CEP: 04547-005 Vila Olimpia - São Paulo/SP, Brasil
Tel.: + 55 11 3841-9943 Fax: + 55 11 3044-0463
www.nkbr.com.br





FONTE DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Equipamento de iluminação de alta qualidade de iluminação em tubo perfurado de aço, pintura eletrolítica, produzidos totalmente em Portugal. Cabeça regulável em altura e haste flexível articulada. Cabeça em alumínio. Possui dois braços giratórios tipo bola de 2". Regulagem de altura com sistema de trava em aço inoxidável de perfil e bloqueio.

MODELOS:

- LV 100 - Luminária colgante 100W, Alimentação: 12 ou 220 volts.
- LV 79 - Luminária articulada, cabeça articulada 50W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 76 - Luminária articulada 50W, Alimentação: 110 ou 220 volts. Cabeça articulada.
- LV 107 LED - Luminária LED 20W, Alimentação: 12 ou 220 volts.
- LV 79 LED - Luminária articulada, cabeça articulada LED 50W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 70 LED - Luminária LED 30W, Alimentação: 12 ou 220 volts.

Dimensões: Base 0,40m x Alt. 1,80m - Flexível e Cabeça 0,40m x Alt. 1,20m/1,50m.



SUPORTE DE BRAÇO


Tubo perfurado em aço, cabeça flexível e haste regulável em tubo perfurado de aço e cabeça em aço, cabeça articulada. Regulagem de altura com sistema de trava em aço inoxidável de perfil e bloqueio. Possui contêiner de PVC, antiderrapante.

MODELOS:

- LV 101 - Regulagem de altura e cabeça articulada em aço.
- LV 102 - Regulagem de altura e cabeça articulada em aço, cabeça articulada.
- LV 103 - Regulagem de altura e cabeça articulada em aço, cabeça articulada.

Dimensões: C 0,40m x A 0,80m/1,00m/1,20m/1,50m/1,80m/2,00m/2,20m/2,40m/2,60m/2,80m/3,00m/3,20m/3,40m/3,60m/3,80m/4,00m/4,20m/4,40m/4,60m/4,80m/5,00m/5,20m/5,40m/5,60m/5,80m/6,00m/6,20m/6,40m/6,60m/6,80m/7,00m/7,20m/7,40m/7,60m/7,80m/8,00m/8,20m/8,40m/8,60m/8,80m/9,00m/9,20m/9,40m/9,60m/9,80m/10,00m/10,20m/10,40m/10,60m/10,80m/11,00m/11,20m/11,40m/11,60m/11,80m/12,00m/12,20m/12,40m/12,60m/12,80m/13,00m/13,20m/13,40m/13,60m/13,80m/14,00m/14,20m/14,40m/14,60m/14,80m/15,00m/15,20m/15,40m/15,60m/15,80m/16,00m/16,20m/16,40m/16,60m/16,80m/17,00m/17,20m/17,40m/17,60m/17,80m/18,00m/18,20m/18,40m/18,60m/18,80m/19,00m/19,20m/19,40m/19,60m/19,80m/20,00m/20,20m/20,40m/20,60m/20,80m/21,00m/21,20m/21,40m/21,60m/21,80m/22,00m/22,20m/22,40m/22,60m/22,80m/23,00m/23,20m/23,40m/23,60m/23,80m/24,00m/24,20m/24,40m/24,60m/24,80m/25,00m/25,20m/25,40m/25,60m/25,80m/26,00m/26,20m/26,40m/26,60m/26,80m/27,00m/27,20m/27,40m/27,60m/27,80m/28,00m/28,20m/28,40m/28,60m/28,80m/29,00m/29,20m/29,40m/29,60m/29,80m/30,00m/30,20m/30,40m/30,60m/30,80m/31,00m/31,20m/31,40m/31,60m/31,80m/32,00m/32,20m/32,40m/32,60m/32,80m/33,00m/33,20m/33,40m/33,60m/33,80m/34,00m/34,20m/34,40m/34,60m/34,80m/35,00m/35,20m/35,40m/35,60m/35,80m/36,00m/36,20m/36,40m/36,60m/36,80m/37,00m/37,20m/37,40m/37,60m/37,80m/38,00m/38,20m/38,40m/38,60m/38,80m/39,00m/39,20m/39,40m/39,60m/39,80m/40,00m/40,20m/40,40m/40,60m/40,80m/41,00m/41,20m/41,40m/41,60m/41,80m/42,00m/42,20m/42,40m/42,60m/42,80m/43,00m/43,20m/43,40m/43,60m/43,80m/44,00m/44,20m/44,40m/44,60m/44,80m/45,00m/45,20m/45,40m/45,60m/45,80m/46,00m/46,20m/46,40m/46,60m/46,80m/47,00m/47,20m/47,40m/47,60m/47,80m/48,00m/48,20m/48,40m/48,60m/48,80m/49,00m/49,20m/49,40m/49,60m/49,80m/50,00m/50,20m/50,40m/50,60m/50,80m/51,00m/51,20m/51,40m/51,60m/51,80m/52,00m/52,20m/52,40m/52,60m/52,80m/53,00m/53,20m/53,40m/53,60m/53,80m/54,00m/54,20m/54,40m/54,60m/54,80m/55,00m/55,20m/55,40m/55,60m/55,80m/56,00m/56,20m/56,40m/56,60m/56,80m/57,00m/57,20m/57,40m/57,60m/57,80m/58,00m/58,20m/58,40m/58,60m/58,80m/59,00m/59,20m/59,40m/59,60m/59,80m/60,00m/60,20m/60,40m/60,60m/60,80m/61,00m/61,20m/61,40m/61,60m/61,80m/62,00m/62,20m/62,40m/62,60m/62,80m/63,00m/63,20m/63,40m/63,60m/63,80m/64,00m/64,20m/64,40m/64,60m/64,80m/65,00m/65,20m/65,40m/65,60m/65,80m/66,00m/66,20m/66,40m/66,60m/66,80m/67,00m/67,20m/67,40m/67,60m/67,80m/68,00m/68,20m/68,40m/68,60m/68,80m/69,00m/69,20m/69,40m/69,60m/69,80m/70,00m/70,20m/70,40m/70,60m/70,80m/71,00m/71,20m/71,40m/71,60m/71,80m/72,00m/72,20m/72,40m/72,60m/72,80m/73,00m/73,20m/73,40m/73,60m/73,80m/74,00m/74,20m/74,40m/74,60m/74,80m/75,00m/75,20m/75,40m/75,60m/75,80m/76,00m/76,20m/76,40m/76,60m/76,80m/77,00m/77,20m/77,40m/77,60m/77,80m/78,00m/78,20m/78,40m/78,60m/78,80m/79,00m/79,20m/79,40m/79,60m/79,80m/80,00m/80,20m/80,40m/80,60m/80,80m/81,00m/81,20m/81,40m/81,60m/81,80m/82,00m/82,20m/82,40m/82,60m/82,80m/83,00m/83,20m/83,40m/83,60m/83,80m/84,00m/84,20m/84,40m/84,60m/84,80m/85,00m/85,20m/85,40m/85,60m/85,80m/86,00m/86,20m/86,40m/86,60m/86,80m/87,00m/87,20m/87,40m/87,60m/87,80m/88,00m/88,20m/88,40m/88,60m/88,80m/89,00m/89,20m/89,40m/89,60m/89,80m/90,00m/90,20m/90,40m/90,60m/90,80m/91,00m/91,20m/91,40m/91,60m/91,80m/92,00m/92,20m/92,40m/92,60m/92,80m/93,00m/93,20m/93,40m/93,60m/93,80m/94,00m/94,20m/94,40m/94,60m/94,80m/95,00m/95,20m/95,40m/95,60m/95,80m/96,00m/96,20m/96,40m/96,60m/96,80m/97,00m/97,20m/97,40m/97,60m/97,80m/98,00m/98,20m/98,40m/98,60m/98,80m/99,00m/99,20m/99,40m/99,60m/99,80m/100,00m/100,20m/100,40m/100,60m/100,80m/101,00m/101,20m/101,40m/101,60m/101,80m/102,00m/102,20m/102,40m/102,60m/102,80m/103,00m/103,20m/103,40m/103,60m/103,80m/104,00m/104,20m/104,40m/104,60m/104,80m/105,00m/105,20m/105,40m/105,60m/105,80m/106,00m/106,20m/106,40m/106,60m/106,80m/107,00m/107,20m/107,40m/107,60m/107,80m/108,00m/108,20m/108,40m/108,60m/108,80m/109,00m/109,20m/109,40m/109,60m/109,80m/110,00m/110,20m/110,40m/110,60m/110,80m/111,00m/111,20m/111,40m/111,60m/111,80m/112,00m/112,20m/112,40m/112,60m/112,80m/113,00m/113,20m/113,40m/113,60m/113,80m/114,00m/114,20m/114,40m/114,60m/114,80m/115,00m/115,20m/115,40m/115,60m/115,80m/116,00m/116,20m/116,40m/116,60m/116,80m/117,00m/117,20m/117,40m/117,60m/117,80m/118,00m/118,20m/118,40m/118,60m/118,80m/119,00m/119,20m/119,40m/119,60m/119,80m/120,00m/120,20m/120,40m/120,60m/120,80m/121,00m/121,20m/121,40m/121,60m/121,80m/122,00m/122,20m/122,40m/122,60m/122,80m/123,00m/123,20m/123,40m/123,60m/123,80m/124,00m/124,20m/124,40m/124,60m/124,80m/125,00m/125,20m/125,40m/125,60m/125,80m/126,00m/126,20m/126,40m/126,60m/126,80m/127,00m/127,20m/127,40m/127,60m/127,80m/128,00m/128,20m/128,40m/128,60m/128,80m/129,00m/129,20m/129,40m/129,60m/129,80m/130,00m/130,20m/130,40m/130,60m/130,80m/131,00m/131,20m/131,40m/131,60m/131,80m/132,00m/132,20m/132,40m/132,60m/132,80m/133,00m/133,20m/133,40m/133,60m/133,80m/134,00m/134,20m/134,40m/134,60m/134,80m/135,00m/135,20m/135,40m/135,60m/135,80m/136,00m/136,20m/136,40m/136,60m/136,80m/137,00m/137,20m/137,40m/137,60m/137,80m/138,00m/138,20m/138,40m/138,60m/138,80m/139,00m/139,20m/139,40m/139,60m/139,80m/140,00m/140,20m/140,40m/140,60m/140,80m/141,00m/141,20m/141,40m/141,60m/141,80m/142,00m/142,20m/142,40m/142,60m/142,80m/143,00m/143,20m/143,40m/143,60m/143,80m/144,00m/144,20m/144,40m/144,60m/144,80m/145,00m/145,20m/145,40m/145,60m/145,80m/146,00m/146,20m/146,40m/146,60m/146,80m/147,00m/147,20m/147,40m/147,60m/147,80m/148,00m/148,20m/148,40m/148,60m/148,80m/149,00m/149,20m/149,40m/149,60m/149,80m/150,00m/150,20m/150,40m/150,60m/150,80m/151,00m/151,20m/151,40m/151,60m/151,80m/152,00m/152,20m/152,40m/152,60m/152,80m/153,00m/153,20m/153,40m/153,60m/153,80m/154,00m/154,20m/154,40m/154,60m/154,80m/155,00m/155,20m/155,40m/155,60m/155,80m/156,00m/156,20m/156,40m/156,60m/156,80m/157,00m/157,20m/157,40m/157,60m/157,80m/158,00m/158,20m/158,40m/158,60m/158,80m/159,00m/159,20m/159,40m/159,60m/159,80m/160,00m/160,20m/160,40m/160,60m/160,80m/161,00m/161,20m/161,40m/161,60m/161,80m/162,00m/162,20m/162,40m/162,60m/162,80m/163,00m/163,20m/163,40m/163,60m/163,80m/164,00m/164,20m/164,40m/164,60m/164,80m/165,00m/165,20m/165,40m/165,60m/165,80m/166,00m/166,20m/166,40m/166,60m/166,80m/167,00m/167,20m/167,40m/167,60m/167,80m/168,00m/168,20m/168,40m/168,60m/168,80m/169,00m/169,20m/169,40m/169,60m/169,80m/170,00m/170,20m/170,40m/170,60m/170,80m/171,00m/171,20m/171,40m/171,60m/171,80m/172,00m/172,20m/172,40m/172,60m/172,80m/173,00m/173,20m/173,40m/173,60m/173,80m/174,00m/174,20m/174,40m/174,60m/174,80m/175,00m/175,20m/175,40m/175,60m/175,80m/176,00m/176,20m/176,40m/176,60m/176,80m/177,00m/177,20m/177,40m/177,60m/177,80m/178,00m/178,20m/178,40m/178,60m/178,80m/179,00m/179,20m/179,40m/179,60m/179,80m/180,00m/180,20m/180,40m/180,60m/180,80m/181,00m/181,20m/181,40m/181,60m/181,80m/182,00m/182,20m/182,40m/182,60m/182,80m/183,00m/183,20m/183,40m/183,60m/183,80m/184,00m/184,20m/184,40m/184,60m/184,80m/185,00m/185,20m/185,40m/185,60m/185,80m/186,00m/186,20m/186,40m/186,60m/186,80m/187,00m/187,20m/187,40m/187,60m/187,80m/188,00m/188,20m/188,40m/188,60m/188,80m/189,00m/189,20m/189,40m/189,60m/189,80m/190,00m/190,20m/190,40m/190,60m/190,80m/191,00m/191,20m/191,40m/191,60m/191,80m/192,00m/192,20m/192,40m/192,60m/192,80m/193,00m/193,20m/193,40m/193,60m/193,80m/194,00m/194,20m/194,40m/194,60m/194,80m/195,00m/195,20m/195,40m/195,60m/195,80m/196,00m/196,20m/196,40m/196,60m/196,80m/197,00m/197,20m/197,40m/197,60m/197,80m/198,00m/198,20m/198,40m/198,60m/198,80m/199,00m/199,20m/199,40m/199,60m/199,80m/200,00m/200,20m/200,40m/200,60m/200,80m/201,00m/201,20m/201,40m/201,60m/201,80m/202,00m/202,20m/202,40m/202,60m/202,80m/203,00m/203,20m/203,40m/203,60m/203,80m/204,00m/204,20m/204,40m/204,60m/204,80m/205,00m/205,20m/205,40m/205,60m/205,80m/206,00m/206,20m/206,40m/206,60m/206,80m/207,00m/207,20m/207,40m/207,60m/207,80m/208,00m/208,20m/208,40m/208,60m/208,80m/209,00m/209,20m/209,40m/209,60m/209,80m/210,00m/210,20m/210,40m/210,60m/210,80m/211,00m/211,20m/211,40m/211,60m/211,80m/212,00m/212,20m/212,40m/212,60m/212,80m/213,00m/213,20m/213,40m/213,60m/213,80m/214,00m/214,20m/214,40m/214,60m/214,80m/215,00m/215,20m/215,40m/215,60m/215,80m/216,00m/216,20m/216,40m/216,60m/216,80m/217,00m/217,20m/217,40m/217,60m/217,80m/218,00m/218,20m/218,40m/218,60m/218,80m/219,00m/219,20m/219,40m/219,60m/219,80m/220,00m/220,20m/220,40m/220,60m/220,80m/221,00m/221,20m/221,40m/221,60m/221,80m/222,00m/222,20m/222,40m/222,60m/222,80m/223,00m/223,20m/223,40m/223,60m/223,80m/224,00m/224,20m/224,40m/224,60m/224,80m/225,00m/225,20m/225,40m/225,60m/225,80m/226,00m/226,20m/226,40m/226,60m/226,80m/227,00m/227,20m/227,40m/227,60m/227,80m/228,00m/228,20m/228,40m/228,60m/228,80m/229,00m/229,20m/229,40m/229,60m/229,80m/230,00m/230,20m/230,40m/230,60m/230,80m/231,00m/231,20m/231,40m/231,60m/231,80m/232,00m/232,20m/232,40m/232,60m/232,80m/233,00m/233,20m/233,40m/233,60m/233,80m/234,00m/234,20m/234,40m/234,60m/234,80m/235,00m/235,20m/235,40m/235,60m/235,80m/236,00m/236,20m/236,40m/236,60m/236,80m/237,00m/237,20m/237,40m/237,60m/237,80m/238,00m/238,20m/238,40m/238,60m/238,80m/239,00m/239,20m/239,40m/239,60m/239,80m/240,00m/240,20m/240,40m/240,60m/240,80m/241,00m/241,20m/241,40m/241,60m/241,80m/242,00m/242,20m/242,40m/242,60m/242,80m/243,00m/243,20m/243,40m/243,60m/243,80m/244,00m/244,20m/244,40m/244,60m/244,80m/245,00m/245,20m/245,40m/245,60m/245,80m/246,00m/246,20m/246,40m/246,60m/246,80m/247,00m/247,20m/247,40m/247,60m/247,80m/248,00m/248,20m/248,40m/248,60m/248,80m/249,00m/249,20m/249,40m/249,60m/249,80m/250,00m/250,20m/250,40m/250,60m/250,80m/251,00m/251,20m/251,40m/251,60m/251,80m/252,00m/252,20m/252,40m/252,60m/252,80m/253,00m/253,20m/253,40m/253,60m/253,80m/254,00m/254,20m/254,40m/254,60m/254,80m/255,00m/255,20m/255,40m/255,60m/255,80m/256,00m/256,20m/256,40m/256,60m/256,80m/257,00m/257,20m/257,40m/257,60m/257,80m/258,00m/258,20m/258,40m/258,60m/258,80m/259,00m/259,20m/259,40m/259,60m/259,80m/260,00m/260,20m/260,40m/260,60m/260,80m/261,00m/261,20m/261,40m/261,60m/261,80m/262,00m/262,20m/262,40m/262,60m/262,80m/263,00m/263,20m/263,40m/263,60m/263,80m/264,00m/264,20m/264,40m/264,60m/264,80m/265,00m/265,20m/265,40m/265,60m/265,80m/266,00m/266,20m/266,40m/266,60m/266,80m/267,00m/267,20m/267,40m/267,60m/267,80m/268,00m/268,20m/268,40m/268,60m/268,80m/269,00m/269,20m/269,40m/269,60m/269,80m/270,00m/270,20m/270,40m/270,60m/270,80m/271,00m/271,20m/271,40m/271,60m/271,80m/272,00m/272,20m/272,40m/272,60m/272,80m/273,00m/273,20m/273,40m/273,60m/273,80m/274,00m/274,20m/274,40m/274,60m/274,80m/275,00m/275,20m/275,40m/275,60m/275,80m/276,00m/276,20m/276,40m/276,60m/276,80m/277,00m/277,20m/277,40m/277,60m/277,80m/278,00m/278,20m/278,40m/278,60m/278,80m/279,00m/279,20m/279,40m/279,60m/279,80m/280,00m/280,20m/280,40m/280,60m/280,80m/281,00m/281,20m/281,40m/281,60m/281,80m/282,00m/282,20m/282,40m/282,60m/282,80m/283,00m/283,20m/283,40m/283,60m/283,80m/284,00m/284,20m/284,40m/284,60m/284,80m/285,00m/285,20m/285,40m/285,60m/285,80m/286,00m/286,20m/286,40m/286,60m/286,80m/287,00m/287,20m/287,40m/287,60m/287,80m/288,00m/288,20m/288,40m/288,60m/288,80m/289,00m/289,20m/289,40m/289,60m/289,80m/290,00m/290,20m/290,40m/290,60m/290,80m/291,00m/291,20m/291,40m/291,60m/291,80m/292,00m/292,20m/292,40m/292,60m/292,80m/293,00m/293,20m/293,40m/293,60m/293,80m/294,00m/294,20m/294,40m/294,60m/294,80m/295,00m/295,20m/295,40m/295,60m/295,80m/296,00m/296,20m/296,40m/296,60m/296,80m/297,00m/297,20m/297,40m/297,6

Página Inicial > MACAS > PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO

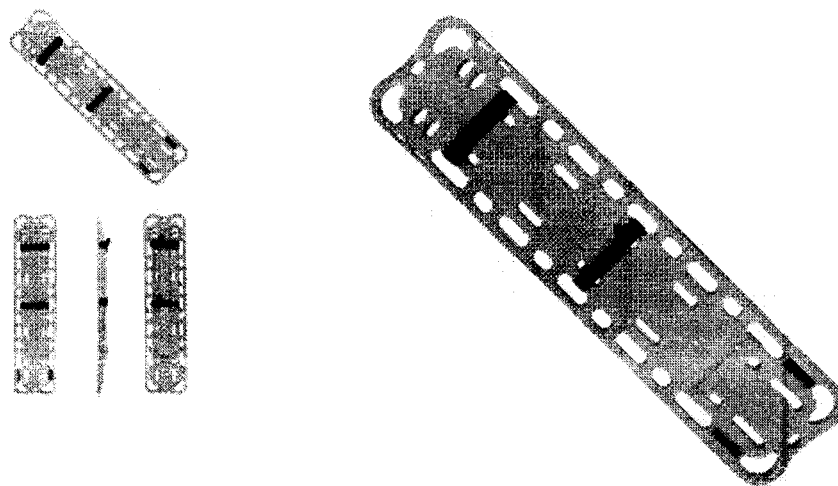


A prancha em polietileno adulto é leve e de fácil manuseio, possui aberturas em sua lateral permitindo a utilização de cinto aranha e imobilizador de cabeça foi produzida em material reforçado da mais alta qualidade, translúcida para utilização em raio x e também pode ser utilizada na água.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

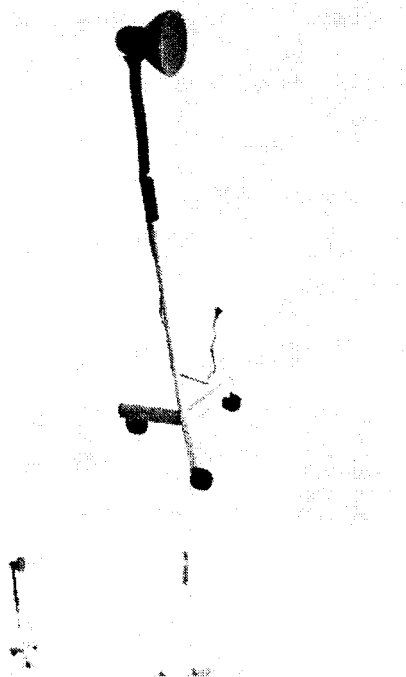

Foco Refletor Parabólico Luz fria

SKU: MS 27106

Categorias: Móveis, MOVEIS HOSPITALARES

Tripé em metalon, com rodízios, base em tubo esmaltado, haste flexível cromada, altura min. 1,250mm , altura max. 1,600mm. > Lampada Superled. > Bivolt automático. >Luz Branca fria 6400k. >Sem emissão de UR e IR. >Economiza 90% de energia. >Potencia equivalente 50watts.

By

6

7



SORTEIO DE LUX PARA

AMBIENTES DE MANIPULADORIAIS

Isso tipo em tubo arredondado de aço, haste de sustentação em tubo redondo de aço, com o sistema de apoio rotatório em antebraço, haste regulável em tubo de aço e haste flexível dobrável. Gancho em alumínio. Para com rebolos quadrado tipo todo de 2". Regulagem de altura com sistema de trava em aço inoxidável de perfil e manípulo.

MODELOS

- LV 102 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 103 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 104 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 105 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 106 LED - Lâmpada LED 30W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 107 LED - Lâmpada LED 30W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 108 LED - Lâmpada LED 30W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 109 LED - Lâmpada LED 30W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 110 LED - Lâmpada LED 30W, Alimentação: 110 ou 220 volts.

Dimensões: Base 1,00m x Alt. 1,00m x Flexível 1,00m x Cabeça 1,00m x Alt. 1,00m x 1,00m.




SUPORTE DE BRAÇO

Tubo para em tubo arredondado de aço, haste fixa e haste regulável em tubo redondo de aço e haste flexível dobrável. Gancho em alumínio. Para com rebolos quadrado tipo todo de 2". Regulagem de altura com sistema de trava em aço inoxidável de perfil e manípulo. Para com rebolos de PVC antiderrapante.

MODELOS

- LV 111 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 112 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 113 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 114 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 115 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 116 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 117 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 118 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 119 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 120 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.

Dimensões: Base 1,00m x Alt. 1,00m x Flexível 1,00m x Cabeça 1,00m x Alt. 1,00m x 1,00m.



SUPORTE DE HAMPER

Estrutura em tubo arredondado de aço, haste regulável em tubo redondo de aço e haste flexível dobrável. Gancho em alumínio. Para com rebolos quadrado tipo todo de 2". Regulagem de altura com sistema de trava em aço inoxidável de perfil e manípulo.

MODELOS

- LV 121 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 122 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 123 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 124 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 125 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 126 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 127 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 128 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 129 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 130 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.

Dimensões: Base 1,00m x Alt. 1,00m x Flexível 1,00m x Cabeça 1,00m x Alt. 1,00m x 1,00m.

OPCIONAIS

- Roda de 2" x 4".
- Saco em algodão.
- Saco em lã.



SUPORTE DE HAMPER COM TAMPA

Estrutura em tubo arredondado de aço, haste regulável em tubo redondo de aço e haste flexível dobrável. Gancho em alumínio. Para com rebolos quadrado tipo todo de 2". Regulagem de altura com sistema de trava em aço inoxidável de perfil e manípulo. Tampa em alumínio antiderrapante.


MODELOS

- LV 131 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 132 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 133 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 134 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 135 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 136 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 137 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 138 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 139 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 140 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.

Dimensões: Base 1,00m x Alt. 1,00m x Flexível 1,00m x Cabeça 1,00m x Alt. 1,00m x 1,00m.

OPCIONAIS

- Roda de 2" x 4".
- Saco em algodão.
- Saco em lã.




SUPORTE DE SORO DE PAREDE

Haste em tubo redondo de aço com 04 ganchos em perfilado de aço, momento de 180°, base de fixação em tubo de aço com dois parafusos.

MODELOS

- LV 141 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 142 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 143 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 144 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 145 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 146 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 147 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 148 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 149 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.
- LV 150 - Lâmpada halógena 100W, Alimentação: 110 ou 220 volts.

Dimensões: Base 1,00m x Alt. 1,00m x Flexível 1,00m x Cabeça 1,00m x Alt. 1,00m x 1,00m.



20

CA

6



RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa)

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

- 01 Amalgamador odontológico
- 02 Equipamento para confecção de próteses
- 03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
- 04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
- 05 Leitora de código de barras
- 06 Máquina para fabricação de comprimidos
- 07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
- 08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
- 09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

- 01 Afiador de navalhas para micrótomo
- 02 Agitador de soluções
- 03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
- 04 Água destilada
- 05 Alça de platina para microbiologia
- 06 Analisador de água
- 07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
- 08 Analisador de tamanho de partículas
- 09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 10 Aparelho para análise de alimentos
- 11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
- 12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
- 14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 15 Aquecedor para laboratório
- 16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
- 17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
- 18 Balança para laboratório
- 19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
- 20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 21 Câmara anaeróbica
- 22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
- 23 Centrifuga, exceto indicada para laboratório de saúde
- 24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
- 25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 29 Corador de lâminas para microscopia
- 30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
- 31 Criostato
- 32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
- 34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 35 Digestor



- 36 Diluidor de amostras
- 37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
- 38 Dispensador de parafina para histologia
- 39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
- 40 Equipamento para gerenciamento de amostras
- 41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
- 42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
- 45 Evaporador centrífugo a vácuo
- 46 Fermentador de culturas
- 47 Filtro para soluções
- 48 Forno mufla
- 49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
- 51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
- 52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
- 53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
- 54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
- 56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
- 57 Lenço para assepsia da pele
- 58 Liofilizador
- 59 Luxímetro
- 60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
- 61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 62 Medidor do ponto de fusão
- 63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
- 64 Micrótomo para histologia
- 65 Mobiliário para laboratório
- 66 Moinho de amostras sólidas
- 67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 69 Pipeta automática
- 70 Pipeta ou micropipeta manual
- 71 Porta algodão
- 72 Porta papeleta
- 73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 74 Processadora de tecidos para histologia
- 75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
- 76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
- 77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
- 78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
- 80 Suporte para artigos de laboratório
- 81 Temporizador
- 82 Titulador
- 83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

- 01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
- 01.1 – Condicionadores de ar
- 01.2 – Purificador de ar

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



- 01.3 – Esterilizador de ar
- 01.4 – Umidificador de ar
- 02 Balde
- 03 Bandeja, exceto para esterilização
- 04 Barreira para separação de ambientes
- 04.1 Biombo
- 05 Bomba a vácuo
- 06 Caldeira
- 07 Central de ar comprimido
- 08 Central de gases medicinais
- 09 Central de vácuo
- 10 Compressor de ar
- 11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
- 12 Cortador de isopor para confecção de moldes
- 13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
- 14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
- 14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
- 15 Equipamentos para Lavanderia
- 16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
- 17 Escova para limpeza de produtos em geral
- 18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
- 19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
- 20 Fogão para preparação de alimentos
- 21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
- 22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
- 23 Gerador de vapor
- 24 Incinerador de resíduos hospitalares
- 25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
- 26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
- 26.2 – Cadeiras de espera
- 26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
- 26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
- 26.5 – Mesa de cabeceira
- 26.6 – Mesa para Necrópsia
- 27 Negatoscópio
- 28 Papel higiênico
- 29 Pia hospitalar
- 30 Protetor auricular de ruídos
- 31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
- 33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
- 34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
- 35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
- 36 Secador de ar medicinal
- 37 Seladora de embalagens de produtos médicos
- 38 Sistema de comunicação hospitalar
- 39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

- 01 Manequim para treinamento médico
- 02 Modelo de Órgão para ensino

22

2

2

03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

- 01 Armadilha para desinfestação
- 02 Bomba para dedetização
- 03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
- 04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

- 01 Barra para ginástica
- 02 Bola
- 03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
- 04 Cronômetro
- 04.1 Relógio para treinamento
- 05 Dardo
- 06 Dilatador nasal adesivo
- 07 Disco
- 08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
- 08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 08.2 – Halteres
- 08.3 – Estações de Musculação
- 08.4 - Remadores
- 08.5 – Aparelho para abdominais
- 09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 10 Mesa ou cadeira para massagem
- 11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
- 12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
- 13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
- 14 Tablado (exceto para fisioterapia)
- 15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

- 01 Absorvente higiênico
- 02 Alicates para cortar unhas
- 03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
- 03.1 – Condicionadores de ar
- 03.2 – Purificador de ar
- 03.3 – Esterilizador de ar
- 03.4 – Umidificador de ar
- 04 Balanças (exceto as indicadas para diagnóstico médico)
- 05 Barbeador
- 06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
- 07 Chupeta
- 08 Escova odontológica
- 09 Escova para cabelos
- 10 Esponja para limpeza de pele
- 11 Fio dental
- 12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
- 13 Lente para ampliar escalas
- 14 Limpador de língua
- 15 Mamadeira e bico
- 16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
- 17 Massageador de gengiva

Handwritten marks: A stylized signature or mark, a small hook-like mark, and a small downward-pointing mark.

- 20 Massagador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
- 21 Mordedor para lactentes
- 22 Óculos para presbiopia
- 23 Passador de fio dental
- 24 Produto para estimulação sexual
- 25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
- 26 Purificador de água
- 27 Sauna
- 28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

- 01 Câmera fotográfica de uso geral
- 02 Equipamento de informática de uso geral
- 03 Filme fotográfico comum de uso geral
- 04 Fixador ou revelador de filmes
- 05 Gravador de imagens
- 06 Impressora
- 07 Monitor de vídeo
- 08 Óleo lubrificante
- 09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

24

11


2

MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1802.01.2025-PE
PROCESSO Nº 1802.01.2025-PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

LOTE ÚNICO									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPAS E PEDAL BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPAS E PEDAL.	MERCONPLAS	BALDE COM PEDAL	Unidade	4	mil e vinte e dois reais e sessenta centavos	R\$ 255,65 /	mil e vinte e dois reais e sessenta centavos	R\$ 1.022,60
2	BIOMBO HOSPITALAR BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TIPO TRIPLO DOBRÁVEL ALTURA CERCADE A PARTIR DE 1,80 M, ABERTO TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATORIAS	TUBOMED	TM 078	Unidade	3	seis mil, duzentos e noventa e sete reais e nove centavos	R\$ 2.099,33	seis mil, duzentos e noventa e sete reais e nove centavos	R\$ 6.297,99
3	CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA 1 CABO PARA BISTURI Nº3 LÂMINA 10 A 17 2 GANCHO DE JOSEPH Nº 1 DELICADO 17CM 1 EXTRATOR DE COMEDÃO TIPO ALEMÃO 2 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA 1 TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR T/C VÍDEA 12 CM 1 PINÇA ADSON COM DENTE 1X2 12 CM 1 PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA 14 CM 1 TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM 1 ESTOJO DE INOX PERFURADO 18X08X05 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS	BRASMED	CX CIRURGICA COMPLETA	Unidade	3	seis mil, setecentos e noventa reais e dezessete centavos	R\$ 2.263,39	seis mil, setecentos e noventa reais e dezessete centavos	R\$ 6.790,17
4	COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS.	MEDAXO	COLAR CERVICAL STAM	Unidade	1	cento e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 134,57	cento e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 134,57
5	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO - CARDIOVERSOR BIFÁSICO INSTRAMED CARDIOMAX-DIMENSÕES COM PÁS: 30,0 CM LARGURA. 21,5 CM PROFUNDIDADE. 28,0 CM ALTURA. PESO: APARELHO - 5,15 KG. BATERIA NIMH - 1,10 KG. BATERIA LI-ION - 0,60 KG.PÁS EXTERNAS - 0,85 KG. EQUIPAMENTO COMPLETO BATERIA NIMH 7,10 KG EXCETO PANI. EQUIPAMENTO COMPLETO BATERIA LI-ION 6,60 KG EXCETO PANI. ELÉTRICO:AC: 100 A 265 VAC, 50/60 HZ SELEÇÃO AUTOMÁTICA. DC EXTERNO: 11 A 16 VDC. BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL: TIPO: NIMH, 14,4 VDC 4,5 A/H. DURAÇÃO:BATERIA COM CARGA PLENA - 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA COMPLETAMENTE DESCARREGADA: 8 HORAS. BATERIA OPCIONAL*: TIPO: LI-ION, 14,8 VDC 4,4 A/H.DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA COMPLETAMENTE DESCARREGADA: 8 HORAS. **CONSULTAR DISPONIBILIDADE. MEMÓRIA: TIPO: FLASH NAND. CAPACIDADE: 2 MBYTES. PACIENTES ARMAZENADOS: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ECG: GRAVAÇÃO D CTR - CHECAGEM EM TEMPO REAL DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION: AUTO-DIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉCONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE	INSTRAMED	CARDIOMAX 8	Unidade	4	noventa mil, quatrocentos e setenta e seis reais	R\$ 22.619,00	noventa mil, quatrocentos e setenta e seis reais	R\$ 90.476,00
6	FOCO CIRURGICO MÓVEL FOCO CIRURGICO MÓVEL.	MEDPEJ	ALP7E	Unidade	1	mil setecentos e sessenta e um reais e dezessete centavos	R\$ 1.761,17	mil setecentos e sessenta e um reais e dezessete centavos	R\$ 1.761,17



7	PRANCHA LONGA PRANCHA LONGA	SP RESGATE	PRANCHA LONGA	Unidade	2	mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos	R\$ 664,67	mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.329,34
8	REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA.	MACHE	FOCO REFLETOR	Unidade	1	trezentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos	R\$ 396,26	trezentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos	R\$ 396,26
9	SUPORTE DE HAMPER. SUPORTE DE HAMPER	TUBOMED	TM 033	Unidade	2	mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos	R\$ 825,39	mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos	R\$ 1.650,78
VALOR TOTAL DO LOTE									R\$ 189.858,98
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO									cento e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos

VALIDADE: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias.

ENTREGA: Os itens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

PACOTI - 24 DE MARÇO DE 2025




25 de Março de 2025.

A


PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
ESTADO DO CEARÁ

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 1802.01.2025-PE



CARTA PROPOSTA INICIAL

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
LOTE ÚNICO					
01	04	BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPAS E PEDAL BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPAS E PEDAL.	ARTINOX / INOX	255,00	1.020,00
02	03	BIOMBO HOSPITALAR BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TIPO TRIPLO DOBRÁVEL ALTURA CERCADA A PARTIR DE 1,80 M. ABERTO TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATORIAS	LIFENOX / TRIPLO	2090,00	6.270,00
03	03	CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA 1 CABO PARA BISTURI Nº3 LAMINA 10 A 17 2 GANCHO DE JOSEPH Nº 1 DELICADO 17CM 1 EXTRATOR DE COMEDÃO TIPO ALEMÃO 2 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA 1 TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR T/C VÍDEA 12 CM 1 PINÇA ADSON COM DENTE 1X2 12 CM 1 PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA 14 CM 1 TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM 1 ESTOJO DE INOX PERFURADO 18X08X05 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS	ABC / INSTRUMENTAL	2260,00	6.780,00
04	01	COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS.	RESGATE / KIT	134,00	134,00
05	04	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO - CARDIOVERSOR BIFÁSICO INSTRAMED CARDIOMAX-DIMENSÕES COM PÁS: 30,0 CM LARGURA. 21,5 CM PROFUNDIDADE. 28,0 CM ALTURA. PESO: APARELHO - 5,15 KG. BATERIA NIMH - 1,10 KG. BATERIA LI-ION - 0,60 KG. PÁS EXTERNAS - 0,85 KG. EQUIPAMENTO COMPLETO BATERIA NIMH 7,10 KG EXCETO PAINEL. EQUIPAMENTO COMPLETO BATERIA LI-ION 6,60 KG EXCETO PAINEL. ELÉTRICO: AC: 100 A 265 VAC, 50/60 HZ SELEÇÃO AUTOMÁTICA. DC EXTERNO: 11 A 16 VDC. BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL: TIPO: NIMH, 14,4 VDC 4,5 A/H. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA - 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA COMPLETAMENTE DESCARREGADA: 8 HORAS. BATERIA OPCIONAL**: TIPO: LI-ION, 14,8 VDC 4,4 A/H. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA COMPLETAMENTE DESCARREGADA: 8 HORAS. **CONSULTAR DISPONIBILIDADE. MEMÓRIA: TIPO: FLASH NAND. CAPACIDADE: 2 MBYTES. PACIENTES ARMAZENADOS: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM CHOQUE. ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ECG: GRAVAÇÃO D CTR - CHECAGEM EM TEMPO REAL DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION: AUTO-DIAGNÓSTICO DE DEFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉCONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE	CMOS DRAKE / VIVO GOLD	22619,00	90.476,00
06	01	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL FOCO CIRÚRGICO MÓVEL.	MEDPEJ / FL2000	1761,00	1.761,00
07	02	PRANCHA LONGA PRANCHA LONGA	RESGATE / KIT	664,00	1.328,00



08	01	REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA	LIFENOX / LED	396,00	396,00
09	02	SUPORTE DE HAMPER. SUPORTE DE HAMPER	LIFENOX / HAMPER	825,00	1.650,00

VALOR TOTAL DO LOTE: 109.815,00 CIENTO E NOVE MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS


VALOR DA PROPOSTA: 109.815,00

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Conforme edital.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra. Conforme edital.
Prazo de Pagamento: Conforme edital.
Prazo de Garantia: Conforme o edital



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPA E PEDAL BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPA E PEDAL.	CLINK	UND	4	R\$ 255,65	R\$ 1.022,60
2	BIOMBO HOSPITALAR BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TIPO TRIPLO DOBRAVEL ALTURA CERCADE A PARTIR DE 1,80 M, ABERTO TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATORIAS	TUBOMED	UND	3	R\$ 2.099,33	R\$ 6.297,99
3	CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA 1 CABO PARA BISTURI Nº3 LÂMINA 10 A 17 2 GANCHO DE JOSEPH Nº 1 DELICADO 17CM 1 EXTRATOR DE COMEDÃO TIPO ALEMÃ 2 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA 1 TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR T/C VÍDEA 12 CM 1 PINÇA ADSON COM DENTE 1X2 12 CM 1 PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA 14 CM 1 TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM 1 ESTOJO DE INOX PERFURADO 18X08X05 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS	ABC	UND	3	R\$ 2.263,39	R\$ 6.790,17
4	COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS.	RESGATE SP	UND	1	R\$ 134,57	R\$ 134,57
5	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO - CARDIOVERSOR BIFÁSICO INSTRAMED CARDIOMAX-DIMENSÕES COM PÁS: 30,0 CM LARGURA. 21,5 CM PROFUNDIDADE. 28,0 CM ALTURA. PESO: APARELHO - 5,15 KG. BATERIA NIMH - 1,10 KG. BATERIA LI-ION - 0,60 KG. PÁS EXTERNAS - 0,85 KG. EQUIPAMENTO COMPLETO BATERIA NIMH 7,10 KG EXCETO PANI. EQUIPAMENTO COMPLETO BATERIA LI-ION 6,60 KG EXCETO PANI. ELÉTRICO:AC: 100 A 265 VAC, 50/60 HZ SELEÇÃO AUTOMÁTICA. DC EXTERNO: 11 A 16 VDC. BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL: TIPO: NIMH, 14,4 VDC 4,5 A/H. DURAÇÃO:BATERIA COM CARGA PLENA - 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA COMPLETAMENTE DESCARREGADA: 8 HORAS. BATERIA OPCIONAL**: TIPO: LI-ION, 14,8 VDC 4,4 A/H.DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA COMPLETAMENTE DESCARREGADA: 8 HORAS. **CONSULTAR DISPONIBILIDADE. MEMÓRIA: TIPO: FLASH NAND. CAPACIDADE: 2 MBYTES. PACIENTES ARMAZENADOS: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ECG: GRAVAÇÃO D CTR - CHECAGEM EM TEMPO REAL DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION: AUTO-DIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉCONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE	ECAFIX	UND	4	R\$ 22.619,00	R\$ 90.476,00
6	FOCO CIRURGICO MÓVEL FOCO CIRURGICO MÓVEL.	VAGALUMY	UND	1	R\$ 1.761,17	R\$ 1.761,17
7	PRANCHA LONGA PRANCHA LONGA	VNO	UND	2	R\$ 664,67	R\$ 1.329,34
8	REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA.	TECHLUZ	UND	1	R\$ 396,26	R\$ 396,26
9	SUORTE DE HAMPER. SUORTE DE HAMPER	TUBOMED	UND	2	R\$ 825,39	R\$ 1.650,78
VALOR TOTAL DO PRODUTO:					R\$ 109.858,88	
cento e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos						

A PRESENTE PROPOSTA ESCRITA É VÁLIDA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.
- O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.
- O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
- O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.


By

JA

1

- TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.
- PRAZO DE GARANTIA CONFORME O EDITAL.
- DECLARAMOS QUE SERÁ POSSÍVEL O FORNECIMENTO DO OBJETO DA PROPOSTA DE PREÇOS, E AINDA, QUE NOS COMPROMETEMOS COM O FORNECIMENTO.

21 de março de 2025



Handwritten signatures or initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI
CUIDANDO DA NOSSA GENTE



PROPOSTA AJUSTADA

59

24

AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Capitão Gutemberg, nº 1001 A - Cidade Funcionários, Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 FONE: (85) 98671.3738
C.G.F. 06.173.963-4 Insc. Municipal. 512877-3
E-mail: licitagile@outlook.com CNPJ: 34.523.353/0001-98

PROPOSTA DE PREÇO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1802.01.2025-PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE.

AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 34.523.353/0001-98 C.G.F. 06.173.963-4 INSC. MUNICIPAL. 512877-3:
RUA CAPITÃO GUTEMBERG, Nº 1001 A - CIDADE FUNCIONÁRIOS, FORTALEZA/CE - CEP: 60.823-050
TEL: (85) 98671.3738 - E-MAIL: AGILELICITACOESCONTRATOS@GMAIL.COM | LICITAGILE@OUTLOOK.COM
DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO 033 AG.0624-6 C/C. 46446-5 - AGILE DISTRIBUIDORA LTDA

LOTE/ITEM						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPÃO E PEDAL BALDE COM PEDAL CONTENDO RESÍDUOS COM TAMPÃO E PEDAL	UNIDADE	4	JSN	R\$ 253,00	R\$ 1.012,00
2	BIOMBO HOSPITALAR BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXÍVEL TIPO TRIPLO DOBRÁVEL ALTURA CERCADE A PARTIR DE 1,80 M, ABERTO TIPO DE RODÍZIO PONTES GIRATORIAS	UNIDADE	3	TUBOMED	R\$ 640,00	R\$ 1.920,00
3	CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA CAIXA DE CIRURGIA COMPLETA 1 CABO PARA BISTURI Nº43 LÂMINA 10 A 172 GANCHO DE JOSEPH Nº 1 DEUCADO 17CM 1 EXTRATOR DE COMEDÃO TIPO ALEMÃO 2 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA 1 TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR T/C VÍDEA 12 CM 1 PINÇA ADSON COM DENTE 1X2 12 CM 1 PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA 14 CM 1 TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM 1 ESTOJO DE INOX PERFURADO 18X08X05 CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXÍVEL CIRÚRGICOS	UNIDADE	3	ABC	R\$ 1.700,00	R\$ 5.100,00
4	COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS COLAR CERVICAL KIT COM 5 TAMANHOS.	UNIDADE	1	VIDA RESGATE	R\$ 130,00	R\$ 130,00
5	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARÂMETRO E MARCAPASSO DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARÂMETRO E MARCAPASSO - CARDIOVERSOR BIFÁSICO INSTRUMENTADO CARDIOMAX-DIMENSÕES COM PÁS: 30,0 CM LARGURA. 21,5 CM PROFUNDIDADE. 28,0 CM ALTURA. PESO: APARELHO - 5,15 KG. BATERIA NIMH - 1,10 KG. BATERIA LI-ION - 0,60 KG.PÁS EXTERNAS - 0,85 KG. EQUIPAMENTO COMPLETO BATERIA NIMH 7,10 KG EXCETO PANI. EQUIPAMENTO COMPLETO BATERIA LIION 6,60 KG EXCETO PANI. ELÉTRICO:AC: 100 A 265 VAC, 50/60 HZ SELEÇÃO AUTOMÁTICA. DC EXTERNO: 11 A 16 VDC. BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL: TIPO: NIMH, 14,4 VDC 4,5 A/H. DURAÇÃO:BATERIA COM CARGA PLENA - 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA COMPLETAMENTE DESCARREGADA: 8 HORAS. BATERIA OPCIONAL**: TIPO: LIION, 14,8 VDC 4,4 A/H.DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA COMPLETAMENTE DESCARREGADA: 8 HORAS. **CONSULTAR DISPONIBILIDADE. MEMÓRIA: TIPO: FLASH NAND. CAPACIDADE: 2 MBYTES. PACIENTES ARMAZENADOS: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ECG: GRAVAÇÃO D CTR - CHECKAGEM EM TEMPO REAL DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LIION: AUTO-DIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO A REDE ELÉTRICA. CHECKAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉCONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE	UNIDADE	4	CMOSDRAKE	R\$ 19.000,00	R\$ 76.000,00
6	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL FOCO CIRÚRGICO MÓVEL	UNIDADE	1	MEDPEJ	R\$ 1.033,55	R\$ 1.033,55
7	PRANCHA LONGA PRANCHA LONGA	UNIDADE	2	VIDA RESGATE	R\$ 664,60	R\$ 1.329,20
8	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA.	UNIDADE	1	MEDPEJ	R\$ 396,25	R\$ 396,25
9	SUPORTE DE HAMPER, SUPORTE DE HAMPER	UNIDADE	2	TUBOMED	R\$ 530,00	R\$ 1.060,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 87.981,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	87.981,00
oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO.
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

DECLARO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

DECLARO, SOB AS PENAS LEI, QUE NA PROPOSTA ESTÁ INCLUSO TODOS OS TRIBUTOS, FRETES, TARIFAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO. A PROPOSTA DE PREÇOS COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CERTAME.





DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS/BENS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

FORTALEZA/CE, 26 DE MARÇO DE 2025.

AGILE DISTRIBUIDORA
LTDA:34523353000198
Assinado de forma digital por AGILE DISTRIBUIDORA LTDA:34523353000198
Data: 2025.03.26 14:32:06 -03'00'
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 34.523.353/0001-98

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.